



10 complicaciones asociadas a dispositivos

Infecciones relacionadas con dispositivos invasivos (IRDI)

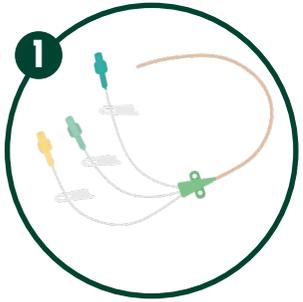

1 INFECCIÓN CATÉTER VENOSO CENTRAL

Bacteriemias por manejo inadecuado o falta de asepsia

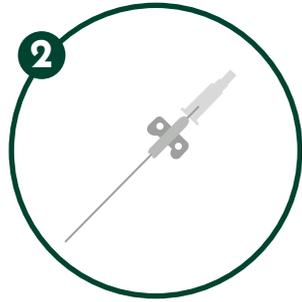


2 INFECCIÓN CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO

Flebitis, infección local o bacteriemia por mala manipulación o permanencia prolongada



3 NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA (NAVIM)


Mala higiene circuitos o técnica incorrecta en manejo tubo endotraqueal/cánula traqueal

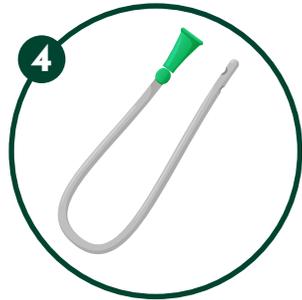

4 INFECCIÓN URINARIA ASOCIADA A SONDAS VESICALES (ITU-SS)


Sondas retenidas más tiempo del necesario o mala técnica en inserción y mantenimiento

Complicaciones mecánicas

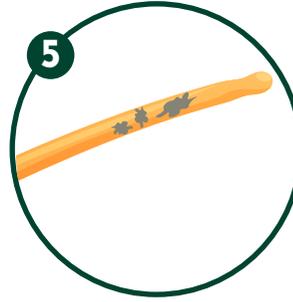


5 OBSTRUCCIÓN

O malfuncionamiento del dispositivo

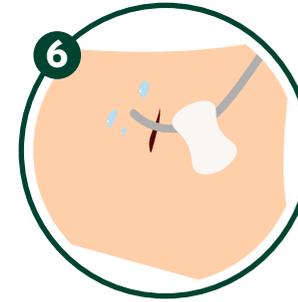


6 DESPLAZAMIENTO

O extracción accidental

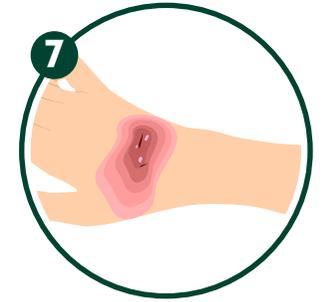

7 LESIONES TISULARES/ VASCULARES

Por inserción incorrecta

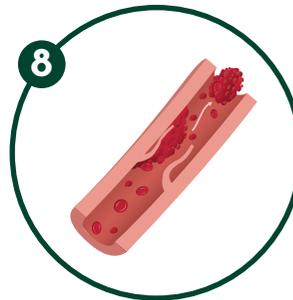


8 TROMBOSIS Y TROMBOFLEBITIS

Por permanencia prolongada o técnicas deficientes



9 DOLOR Y MALESTAR

Por inserción inadecuada o mantenimiento deficiente

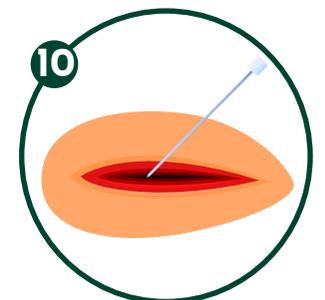

10 COMPLICACIONES EN RETIRADA

Retirada tardío o incorrecto puede causar sangrado o daño tisular