Mantenimiento de los reservorios

PROTOCOLO SAMP

WoCoVa, GAVeCeLT e IVAS

VYGON Value Life

8 PASOS DEL PROTOCOLO



1 EVALUACIÓN DEL RESERVORIO Y DE LA PIEL

Confirmar identidad e historial. Inspeccionar piel sobre bolsillo y túnel (eritema, exudado, erosión). Palpar profundidad y orientación.

STOP: no puncionar ante signos cutáneos o sospecha de rotación (derivar a VAT/POCUS).




2 MANEJO DEL DOLOR

Evaluar ansiedad, fobia a agujas y preferencias. Aplicar anestésico tópico (45-60min antes) y/o distracción con realidad virtual cuando proceda (especialmente en pediatría y pacientes con fobia).



3 PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Reunir kit estéril: CHG alcohólica 2%, guantes y paño fenestrado estériles, mascarillas, **aguja Huber de seguridad** con alargadera preconectada (15-25mm; 21G-19G; power-injectable si alta presión), 2 jeringas SF 10 mL y apósito transparente.

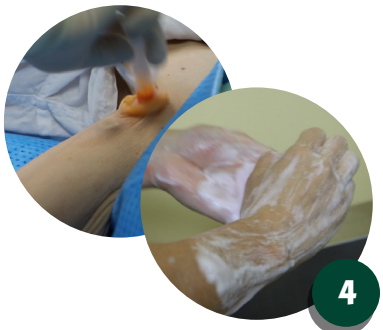


4 HIGIENE Y ANTISEPSIA

Higiene antiséptica de manos. Retirar restos de crema anestésica. Frotar la piel con aplicador monodosis de **CHG 2% en alcohol isopropílico 70% durante 30seg**, dejar secar al aire y colocar barreras estériles.



5 PUNCIÓN DEL RESERVORIO

Purgar sistema con SF en campo estéril. Estabilizar reservorio entre 2 dedos e insertar la aguja Huber **perpendicularmente a 90°** en el septo central hasta tocar el fondo metálico sin forzar. Si falta, deshechar y usar aguja nueva estéril.



6 VERIFICACIÓN DE PERMEABILIDAD

Conectar jeringa de 10 mL, infundir SF, aspirar para confirmar **retorno sanguíneo** y realizar lavado pulsátil (push-pause).

STOP: no forzar ante resistencia, dolor o fuga (investigar PWO u oclusión con VAT)



7 FIJACIÓN Y PROTECCIÓN

Colocar apósito estéril transparente semipermeable de alta transpirabilidad (**MVTR>1500g/m2/24h**), asegurando alas y alargadera sin tensión. Mantener siempre visible el punto de punción.



8 RETIRADA SEGURA DE LA AGUJA

Retirada: confirmar reflujo, orientar bisel opuesto al canal de salida, lavar con **20 mL SF** (push-pause), sellar solo con SF (sin heparina) y retirar bajo **presión positiva.**

Uso continuo: cambiar aguja cada 7 días.

Desuso: lavar con 10 mL SF cada 4-12 semanas.