VYGON
Value Life

RETIRADA DE SecurAcath

1

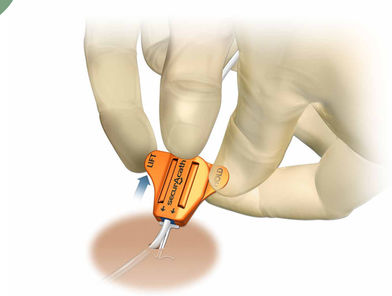

- Agarre la pestaña **HOLD con el pulgar y el dedo índice** para estabilizar el dispositivo y los pies de sujeción bajo la piel.
- Haga palanca hacia arriba en el borde de la lengüeta **LIFT con la punta del dedo índice de la otra mano y el pulgar** colocado en el centro para liberar la tapa de la base.

2

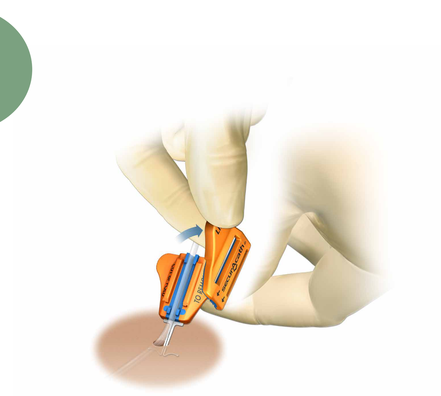

Quitar la parte superior de la base.

3

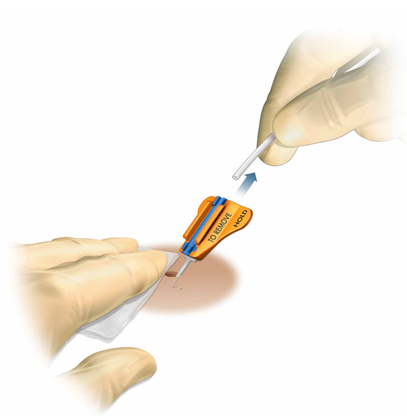

- **Retire** el catéter - no utilice una fuerza excesiva
- **Mantener la presión** en el sitio de punción para lograr la hemostasia
- Si el lugar de inserción está costroso o duro, **aplique una gasa estéril con solución salina** durante unos minutos.
  El tejido se ablandará y la extracción será más fácil. inserción del catéter.

MÉTODO DE PLEGADO

SE PUEDE HACER CON O SIN EL CATÉTER COLOCADO

- **Aplicar una presión firme** en el lugar de inserción para mantener el tejido inmóvil.
- **Doblar las alas** hacia abajo para juntar los pies debajo de la piel.

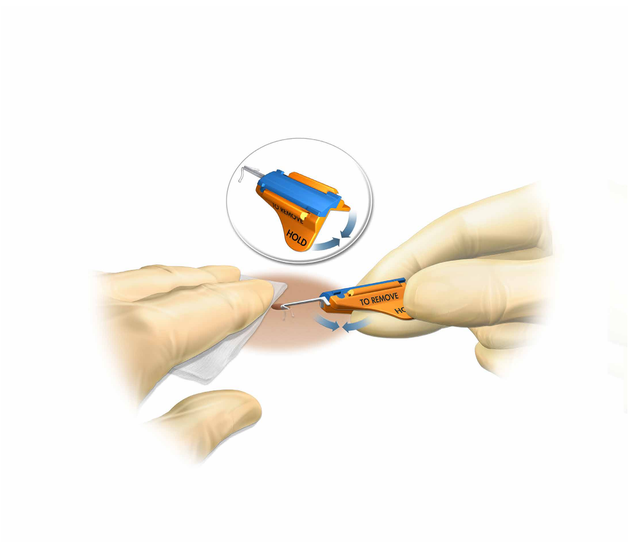

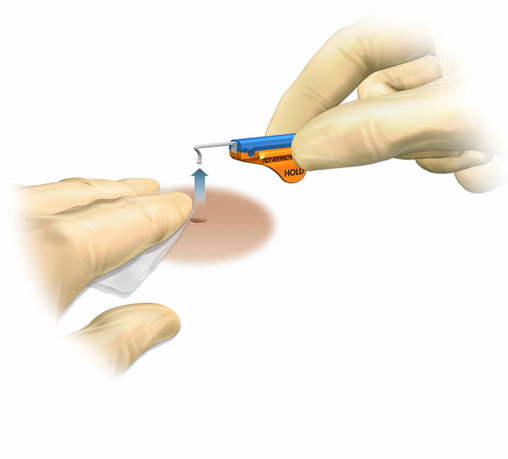

- **Mantener la base plegada** horizontalmente a la piel.
- Utilice un movimiento **rápido y seguro** hacia arriba para retirar siguiendo la forma de los pies.

MÉTODO DE CORTE

EL CATÉTER SE TIENE QUE RETIRAR PREVIAMENTE

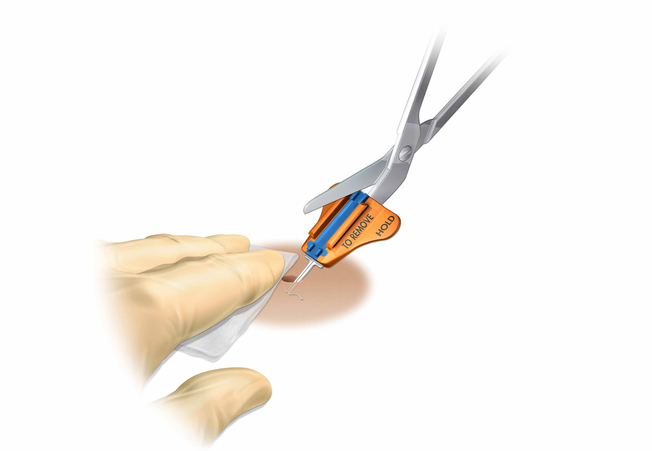

Utilice unas tijeras de punta roma para **cortar toda la base** por la mitad a lo largo de la ranura azul.

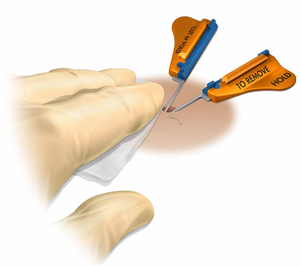

- **Aplique una presión firme** en el lugar de inserción con una mano.
- Los pies flexibles de sujeción tienen forma de "L" y se extienden **5 mm** a cada lado del sitio de inserción.

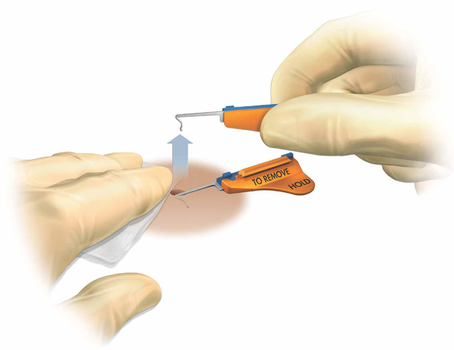

Gire el borde azul hacia arriba y utilice un movimiento **rápido y seguro** hacia arriba para retirar cada pie por separado siguiendo la forma del pie.