Introduction d'un cathéter avec une canule pelable

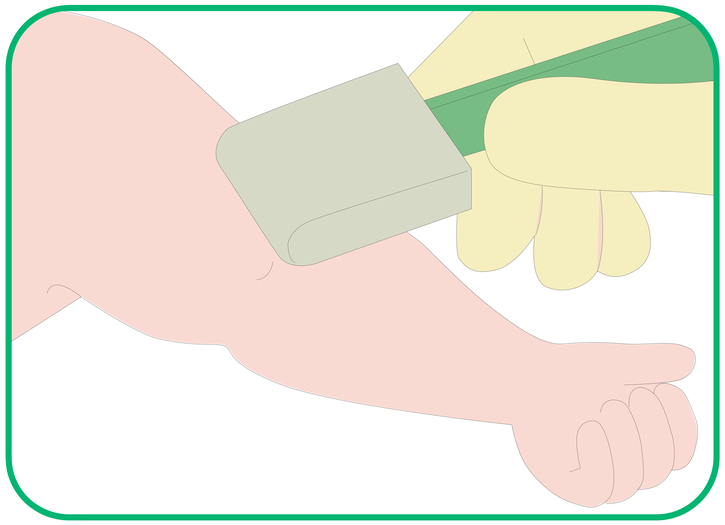

Fig. 1. Sélectionnez la veine, préparez, nettoyez la peau et placez des champs stériles en laissant uniquement le site de ponction exposé. Appliquez un garrot.

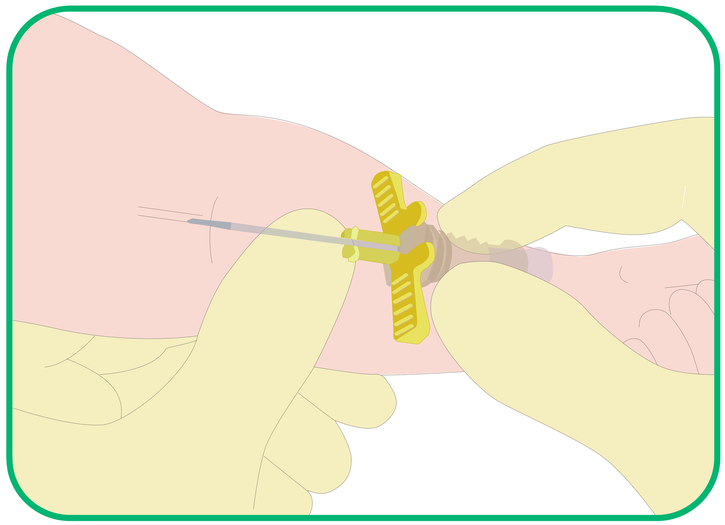

Fig. 2. Réalisez la ponction veineuse avec la canule pelable Microflash fournie, à un angle de 15 à 30 degrés. Avancez la canule jusqu'à ce que la ponction soit confirmée par le reflux sanguin.

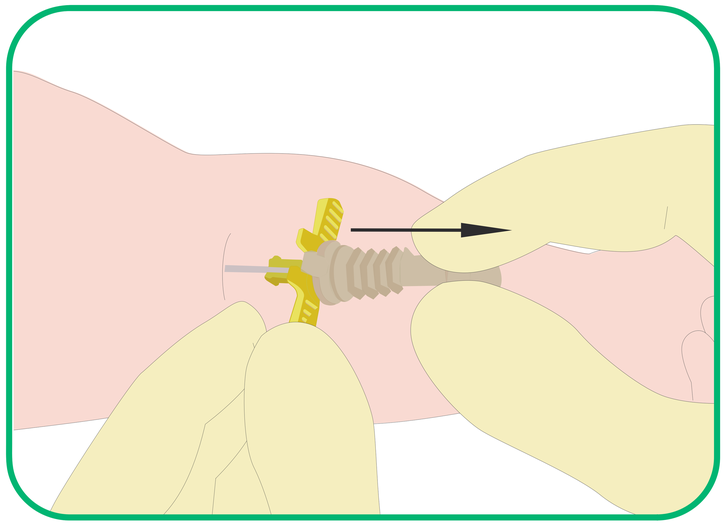

Fig. 3. Abaissez le Microflash de quelques degrés et avancez uniquement la canule en plastique. Retirez le garrot.

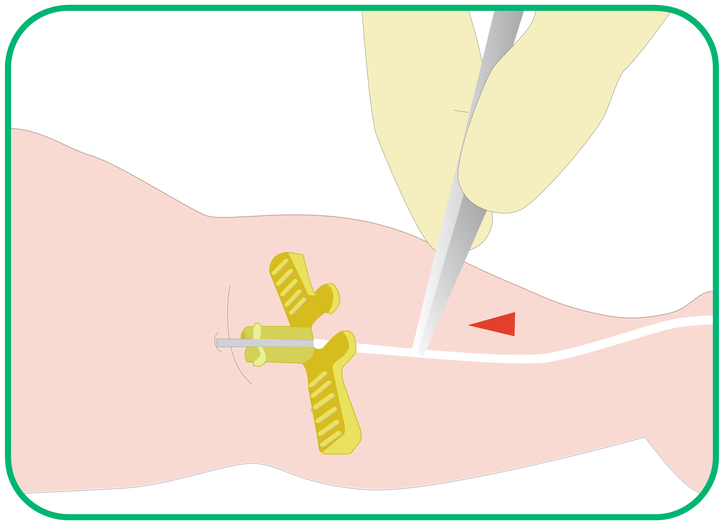

Fig. 4. Passez le cathéter à travers la canule en utilisant des pinces sans dents. Insérez le cathéter suffisamment pour relâcher le garrot et avancez-le progressivement.

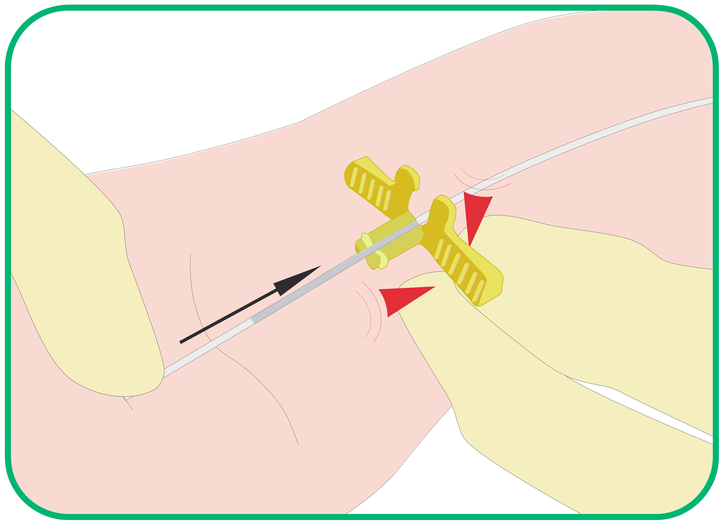

Fig. 5. Sécurisez le cathéter en appliquant une légère pression avec un doigt au-delà de la canule et retirez lentement la canule.

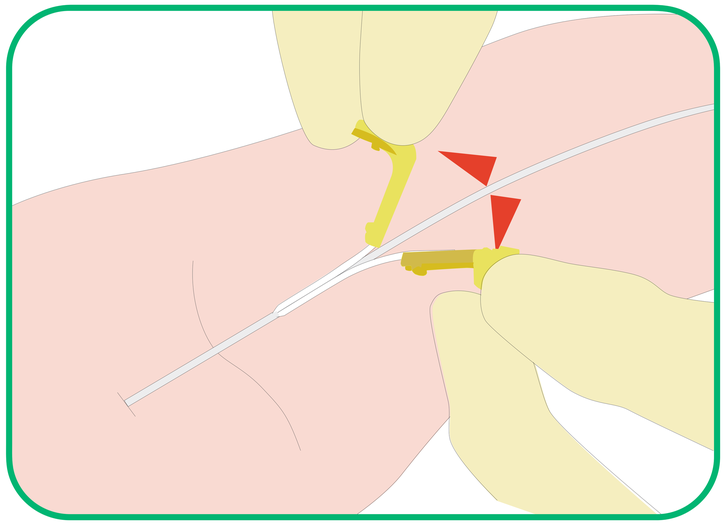

Fig. 6. Une fois que la canule est hors du corps du patient, décollez lentement les deux côtés de la canule en tirant sur les ailettes, en veillant à ne pas déplacer le cathéter. Enfin, placez le cathéter dans la position souhaitée.

VYGON
Value Life